



24 20 02 28 3378

18

SHI



1. 项目概况


2. 项目目标

3. 项目范围

4. 项目组织

5. 项目计划

6. 项目控制

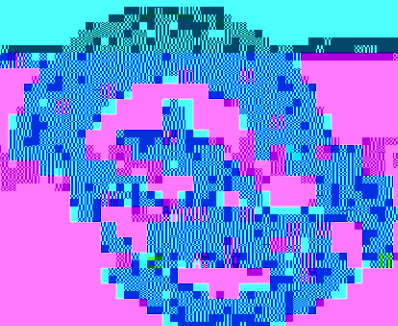

№: GXTL-HI2024158

GXTL/QR-BG-11[A]



“ ”
 “ ”
 “ ”
 “ ”

“ ”

“ ”

“ ”

“ ”
 “ ”

“ ”


“ ”

“ ”

“ ”

“ ”

“ ”

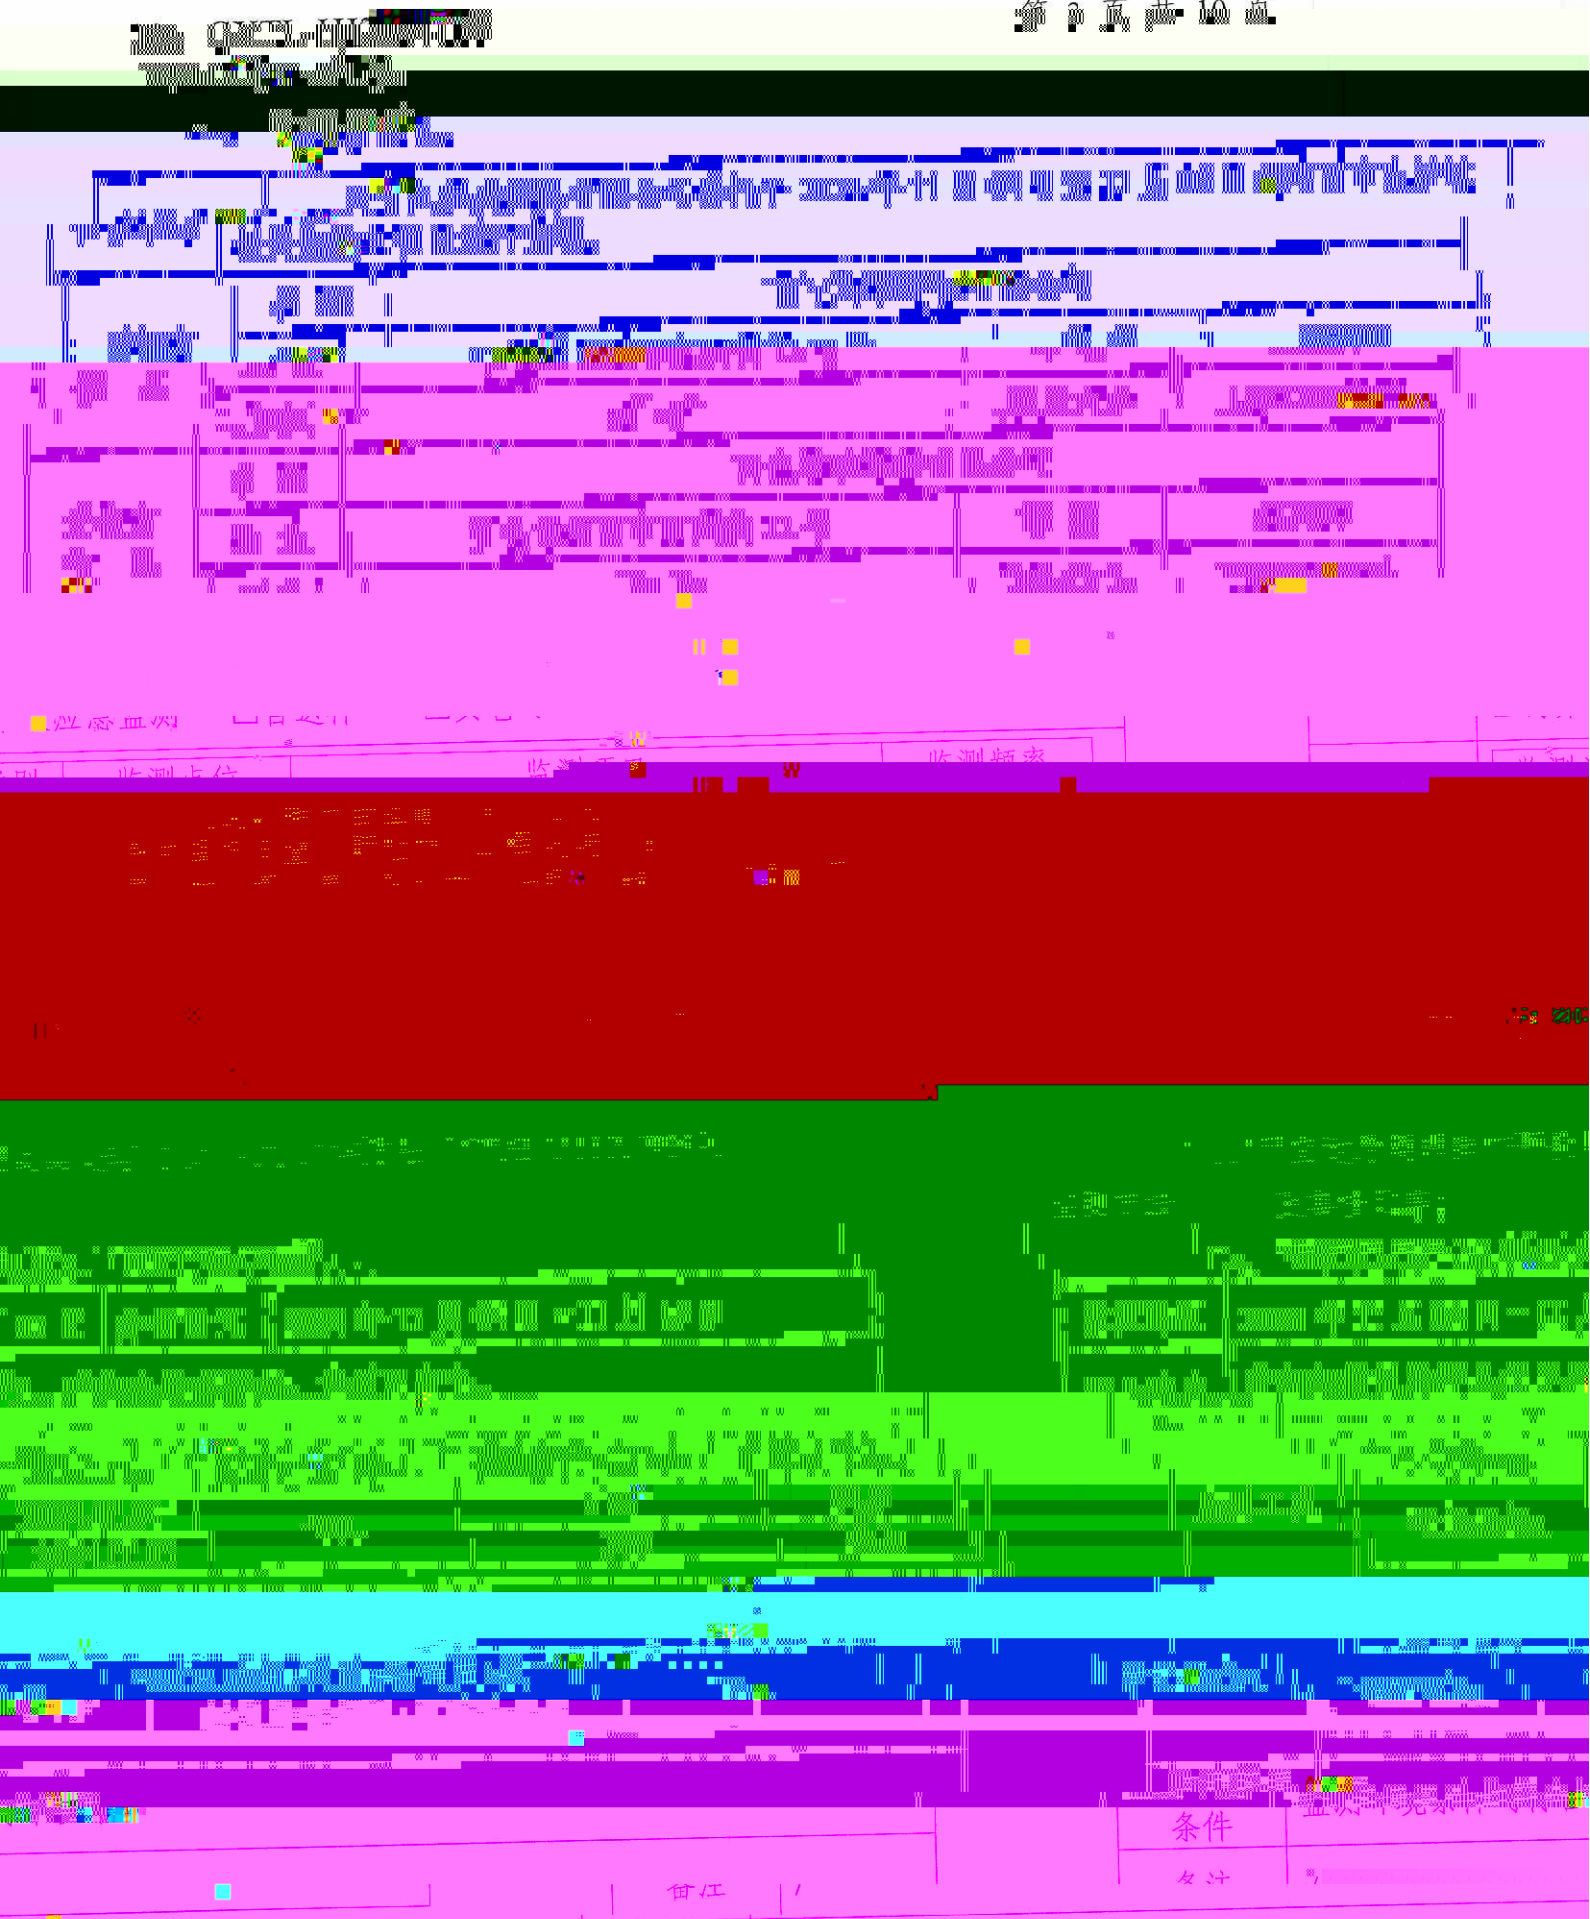

二、监测分析方法及仪器设备信息

监测方法		仪器设备		监测点	监测频次
监测项目	监测依据	检出限或测定下限	设备名称	设备编号	监测类别
1 排气流速	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物测定方法》（GB 16157-1996）	0.01m/s	MH3300 型 烟气烟尘颗粒物 浓度测试仪	HJ-147	日常监测
2 排气含氧量					

织废	(HJ 836-2017)	系统
----	---------------	----

二、监测分析方法及仪器设备信息 (续)

仪器设备

序号	设备名称	设备	类别	号
1	气相色谱仪	700-1700	13	GC-1700
2	液相色谱仪	700-1700	13	LC-1700
3	原子吸收光谱仪	700-1700	13	AAS-1700
4	电感耦合等离子体发射光谱仪	700-1700	13	ICP-AES-1700
5	紫外-可见分光光度计	700-1700	13	UV-1700
6	分光光度计	700-1700	13	SP-1700
7	原子荧光光谱仪	700-1700	13	AAS-1700
8	气相色谱-质谱联用仪	700-1700	13	GC-MS-1700
9	液相色谱-质谱联用仪	700-1700	13	LC-MS-1700
10	电感耦合等离子体-质谱联用仪	700-1700	13	ICP-MS-1700
11	气相色谱-氮磷检测器	700-1700	13	GC-NPD-1700
12	液相色谱-荧光检测器	700-1700	13	LC-FD-1700
13	气相色谱-热稳定性检测器	700-1700	13	GC-TSD-1700
14	液相色谱-电化学检测器	700-1700	13	LC-ED-1700
15	气相色谱-氢火焰离子化检测器	700-1700	13	GC-FID-1700
16	液相色谱-紫外检测器	700-1700	13	LC-UV-1700
17	气相色谱-质谱联用仪	700-1700	13	GC-MS-1700
18	液相色谱-质谱联用仪	700-1700	13	LC-MS-1700
19	电感耦合等离子体-质谱联用仪	700-1700	13	ICP-MS-1700
20	气相色谱-质谱联用仪	700-1700	13	GC-MS-1700
21	液相色谱-质谱联用仪	700-1700	13	LC-MS-1700
22	电感耦合等离子体-质谱联用仪	700-1700	13	ICP-MS-1700
23	气相色谱-质谱联用仪	700-1700	13	GC-MS-1700
24	液相色谱-质谱联用仪	700-1700	13	LC-MS-1700
25	电感耦合等离子体-质谱联用仪	700-1700	13	ICP-MS-1700
26	气相色谱-质谱联用仪	700-1700	13	GC-MS-1700
27	液相色谱-质谱联用仪	700-1700	13	LC-MS-1700
28	电感耦合等离子体-质谱联用仪	700-1700	13	ICP-MS-1700
29	气相色谱-质谱联用仪	700-1700	13	GC-MS-1700
30	液相色谱-质谱联用仪	700-1700	13	LC-MS-1700
31	电感耦合等离子体-质谱联用仪	700-1700	13	ICP-MS-1700
32	气相色谱-质谱联用仪	700-1700	13	GC-MS-1700
33	液相色谱-质谱联用仪	700-1700	13	LC-MS-1700
34	电感耦合等离子体-质谱联用仪	700-1700	13	ICP-MS-1700
35	气相色谱-质谱联用仪	700-1700	13	GC-MS-1700
36	液相色谱-质谱联用仪	700-1700	13	LC-MS-1700
37	电感耦合等离子体-质谱联用仪	700-1700	13	ICP-MS-1700
38	气相色谱-质谱联用仪	700-1700	13	GC-MS-1700
39	液相色谱-质谱联用仪	700-1700	13	LC-MS-1700
40	电感耦合等离子体-质谱联用仪	700-1700	13	ICP-MS-1700
41	气相色谱-质谱联用仪	700-1700	13	GC-MS-1700
42	液相色谱-质谱联用仪	700-1700	13	LC-MS-1700
43	电感耦合等离子体-质谱联用仪	700-1700	13	ICP-MS-1700
44	气相色谱-质谱联用仪	700-1700	13	GC-MS-1700
45	液相色谱-质谱联用仪	700-1700	13	LC-MS-1700
46	电感耦合等离子体-质谱联用仪	700-1700	13	ICP-MS-1700
47	气相色谱-质谱联用仪	700-1700	13	GC-MS-1700
48	液相色谱-质谱联用仪	700-1700	13	LC-MS-1700
49	电感耦合等离子体-质谱联用仪	700-1700	13	ICP-MS-1700
50	气相色谱-质谱联用仪	700-1700	13	GC-MS-1700
51	液相色谱-质谱联用仪	700-1700	13	LC-MS-1700
52	电感耦合等离子体-质谱联用仪	700-1700	13	ICP-MS-1700
53	气相色谱-质谱联用仪	700-1700	13	GC-MS-1700
54	液相色谱-质谱联用仪	700-1700	13	LC-MS-1700
55	电感耦合等离子体-质谱联用仪	700-1700	13	ICP-MS-1700
56	气相色谱-质谱联用仪	700-1700	13	GC-MS-1700
57	液相色谱-质谱联用仪	700-1700	13	LC-MS-1700
58	电感耦合等离子体-质谱联用仪	700-1700	13	ICP-MS-1700
59	气相色谱-质谱联用仪	700-1700	13	GC-MS-1700
60	液相色谱-质谱联用仪	700-1700	13	LC-MS-1700
61	电感耦合等离子体-质谱联用仪	700-1700	13	ICP-MS-1700
62	气相色谱-质谱联用仪	700-1700	13	GC-MS-1700
63	液相色谱-质谱联用仪	700-1700	13	LC-MS-1700
64	电感耦合等离子体-质谱联用仪	700-1700	13	ICP-MS-1700
65	气相色谱-质谱联用仪	700-1700	13	GC-MS-1700
66	液相色谱-质谱联用仪	700-1700	13	LC-MS-1700
67	电感耦合等离子体-质谱联用仪	700-1700	13	ICP-MS-1700
68	气相色谱-质谱联用仪	700-1700	13	GC-MS-1700
69	液相色谱-质谱联用仪	700-1700	13	LC-MS-1700
70	电感耦合等离子体-质谱联用仪	700-1700	13	ICP-MS-1700
71	气相色谱-质谱联用仪	700-1700	13	GC-MS-1700
72	液相色谱-质谱联用仪	700-1700	13	LC-MS-1700
73	电感耦合等离子体-质谱联用仪	700-1700	13	ICP-MS-1700
74	气相色谱-质谱联用仪	700-1700	13	GC-MS-1700
75	液相色谱-质谱联用仪	700-1700	13	LC-MS-1700
76	电感耦合等离子体-质谱联用仪	700-1700	13	ICP-MS-1700
77	气相色谱-质谱联用仪	700-1700	13	GC-MS-1700
78	液相色谱-质谱联用仪	700-1700	13	LC-MS-1700
79	电感耦合等离子体-质谱联用仪	700-1700	13	ICP-MS-1700
80	气相色谱-质谱联用仪	700-1700	13	GC-MS-1700
81	液相色谱-质谱联用仪	700-1700	13	LC-MS-1700
82	电感耦合等离子体-质谱联用仪	700-1700	13	ICP-MS-1700
83	气相色谱-质谱联用仪	700-1700	13	GC-MS-1700
84	液相色谱-质谱联用仪	700-1700	13	LC-MS-1700
85	电感耦合等离子体-质谱联用仪	700-1700	13	ICP-MS-1700
86	气相色谱-质谱联用仪	700-1700	13	GC-MS-1700
87	液相色谱-质谱联用仪	700-1700	13	LC-MS-1700
88	电感耦合等离子体-质谱联用仪	700-1700	13	ICP-MS-1700
89	气相色谱-质谱联用仪	700-1700	13	GC-MS-1700
90	液相色谱-质谱联用仪	700-1700	13	LC-MS-1700
91	电感耦合等离子体-质谱联用仪	700-1700	13	ICP-MS-1700
92	气相色谱-质谱联用仪	700-1700	13	GC-MS-1700
93	液相色谱-质谱联用仪	700-1700	13	LC-MS-1700
94	电感耦合等离子体-质谱联用仪	700-1700	13	ICP-MS-1700
95	气相色谱-质谱联用仪	700-1700	13	GC-MS-1700
96	液相色谱-质谱联用仪	700-1700	13	LC-MS-1700
97	电感耦合等离子体-质谱联用仪	700-1700	13	ICP-MS-1700
98	气相色谱-质谱联用仪	700-1700	13	GC-MS-1700
99	液相色谱-质谱联用仪	700-1700	13	LC-MS-1700
100	电感耦合等离子体-质谱联用仪	700-1700	13	ICP-MS-1700

No. GXTL-QR-11 2024058

GXTL/QR-BG-11[A]

三、监测结果

有组织废气监测结果 (24 炉烟气)

监测点		监测因子		监测结果		监测单位		监测日期		监测人员	
1#炉		SO ₂		0.07×10 ⁻⁴		0.07×10 ⁻⁴		0.07×10 ⁻⁴		0.07×10 ⁻⁴	
2#炉		SO ₂		0.07×10 ⁻⁴		0.07×10 ⁻⁴		0.07×10 ⁻⁴		0.07×10 ⁻⁴	
3#炉		SO ₂		0.07×10 ⁻⁴		0.07×10 ⁻⁴		0.07×10 ⁻⁴		0.07×10 ⁻⁴	
4#炉		SO ₂		0.07×10 ⁻⁴		0.07×10 ⁻⁴		0.07×10 ⁻⁴		0.07×10 ⁻⁴	
5#炉		SO ₂		0.07×10 ⁻⁴		0.07×10 ⁻⁴		0.07×10 ⁻⁴		0.07×10 ⁻⁴	
6#炉		SO ₂		0.07×10 ⁻⁴		0.07×10 ⁻⁴		0.07×10 ⁻⁴		0.07×10 ⁻⁴	
7#炉		SO ₂		0.07×10 ⁻⁴		0.07×10 ⁻⁴		0.07×10 ⁻⁴		0.07×10 ⁻⁴	
8#炉		SO ₂		0.07×10 ⁻⁴		0.07×10 ⁻⁴		0.07×10 ⁻⁴		0.07×10 ⁻⁴	
9#炉		SO ₂		0.07×10 ⁻⁴		0.07×10 ⁻⁴		0.07×10 ⁻⁴		0.07×10 ⁻⁴	
10#炉		SO ₂		0.07×10 ⁻⁴		0.07×10 ⁻⁴		0.07×10 ⁻⁴		0.07×10 ⁻⁴	
11#炉		SO ₂		0.07×10 ⁻⁴		0.07×10 ⁻⁴		0.07×10 ⁻⁴		0.07×10 ⁻⁴	
12#炉		SO ₂		0.07×10 ⁻⁴		0.07×10 ⁻⁴		0.07×10 ⁻⁴		0.07×10 ⁻⁴	
13#炉		SO ₂		0.07×10 ⁻⁴		0.07×10 ⁻⁴		0.07×10 ⁻⁴		0.07×10 ⁻⁴	
14#炉		SO ₂		0.07×10 ⁻⁴		0.07×10 ⁻⁴		0.07×10 ⁻⁴		0.07×10 ⁻⁴	
15#炉		SO ₂		0.07×10 ⁻⁴		0.07×10 ⁻⁴		0.07×10 ⁻⁴		0.07×10 ⁻⁴	
16#炉		SO ₂		0.07×10 ⁻⁴		0.07×10 ⁻⁴		0.07×10 ⁻⁴		0.07×10 ⁻⁴	
17#炉		SO ₂		0.07×10 ⁻⁴		0.07×10 ⁻⁴		0.07×10 ⁻⁴		0.07×10 ⁻⁴	
18#炉		SO ₂		0.07×10 ⁻⁴		0.07×10 ⁻⁴		0.07×10 ⁻⁴		0.07×10 ⁻⁴	
19#炉		SO ₂		0.07×10 ⁻⁴		0.07×10 ⁻⁴		0.07×10 ⁻⁴		0.07×10 ⁻⁴	
20#炉		SO ₂		0.07×10 ⁻⁴		0.07×10 ⁻⁴		0.07×10 ⁻⁴		0.07×10 ⁻⁴	
21#炉		SO ₂		0.07×10 ⁻⁴		0.07×10 ⁻⁴		0.07×10 ⁻⁴		0.07×10 ⁻⁴	
22#炉		SO ₂		0.07×10 ⁻⁴		0.07×10 ⁻⁴		0.07×10 ⁻⁴		0.07×10 ⁻⁴	
23#炉		SO ₂		0.07×10 ⁻⁴		0.07×10 ⁻⁴		0.07×10 ⁻⁴		0.07×10 ⁻⁴	
24#炉		SO ₂		0.07×10 ⁻⁴		0.07×10 ⁻⁴		0.07×10 ⁻⁴		0.07×10 ⁻⁴	

[illegible]

1. 项目背景与目标

2. 项目范围与边界


3. 项目组织与职责

4. 项目进度计划

5. 项目风险管理

6. 项目沟通与报告

7. 项目附录

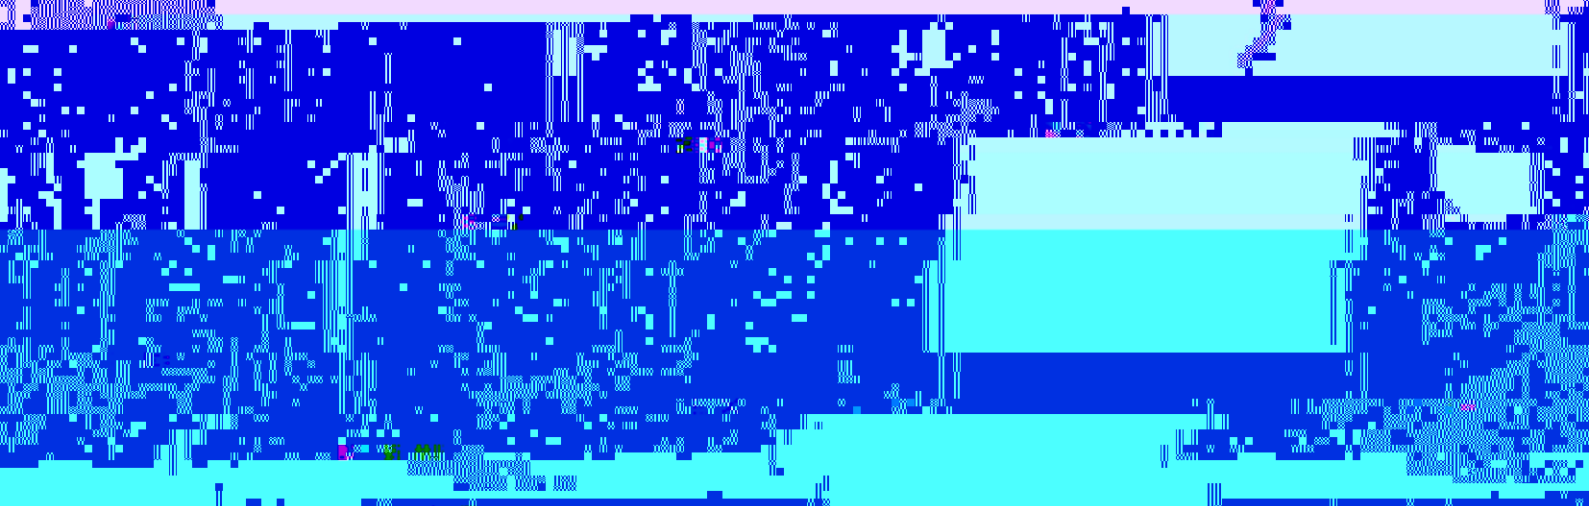

8. 项目总结与展望

9. 项目附件

10. 项目备注

11. 项目附录

12. 项目备注

13. 项目附录